医見書 Ver1.5

バージョンアップ処理説明書

1.バージョンアップ処理画面について

バージョンアップ処理を起動すると、以下のような画面が表示されます。
画面下部に表示されるボタンをクリックして処理を実行します。

医見書Ver1.5 バージョンアップ

医見書Ver1.5

「主治医意見書/訪問看護指示書」作成ソフトウェア

医見書Ver1.5をバージョンアップします。(V1.5.0 -> V.1.5.3)

追加データベースのデータを残す　追加データベースのデータを削除する

医見書Ver1.5のバージョンアップ処理を開始します。

企画・制作：社団法人　日本医師会
開　　発：日本医師会総合政策研究機構
開発協力：(株)帝人システムテクノロジー

Copyright 日本医師会 1999-2000

バージョンアップ　バージョンアップ前の状態に戻す　キャンセル
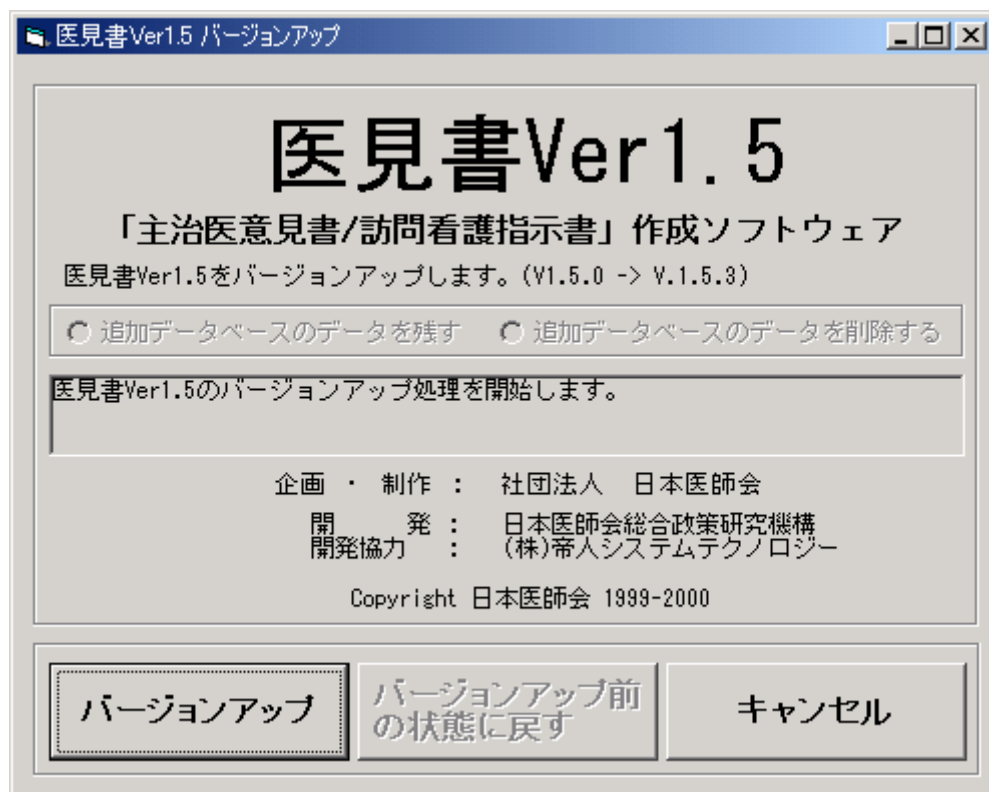
医見書 Ver1.5 のバージョンアップ処理実行後、または既にバージョンアップされている場合、
以下のように【バージョンアップ】ボタンは使用不可の状態になり、
【バージョンアップ前の状態に戻す】ボタンが使用可能になります。

バージョンアップ　バージョンアップ前の状態に戻す　キャンセル

2.バージョンアップ処理

医見書Ver1.5 バージョンアップ

医見書Ver1.5

「主治医意見書/訪問看護指示書」作成ソフトウェア

医見書Ver1.5をバージョンアップします。(V1.5.0 -> V.1.5.3)

追加データベースのデータを残す　追加データベースのデータを削除する

医見書Ver1.5のバージョンアップ処理を開始します。

企画・制作：社団法人　日本医師会
開　　発：日本医師会総合政策研究機構
開発協力：(株)帝人システムテクノロジー

Copyright 日本医師会 1999-2000

バージョンアップ　バージョンアップ前の状態に戻す　キャンセル

【バージョンアップ】ボタンをクリックすると処理を開始します。

【キャンセル】ボタンをクリックすると画面を終了します。
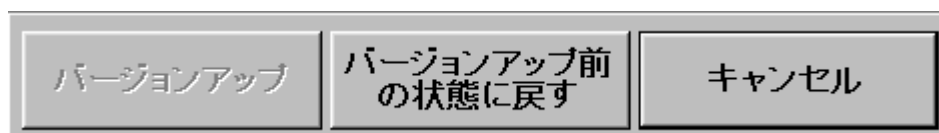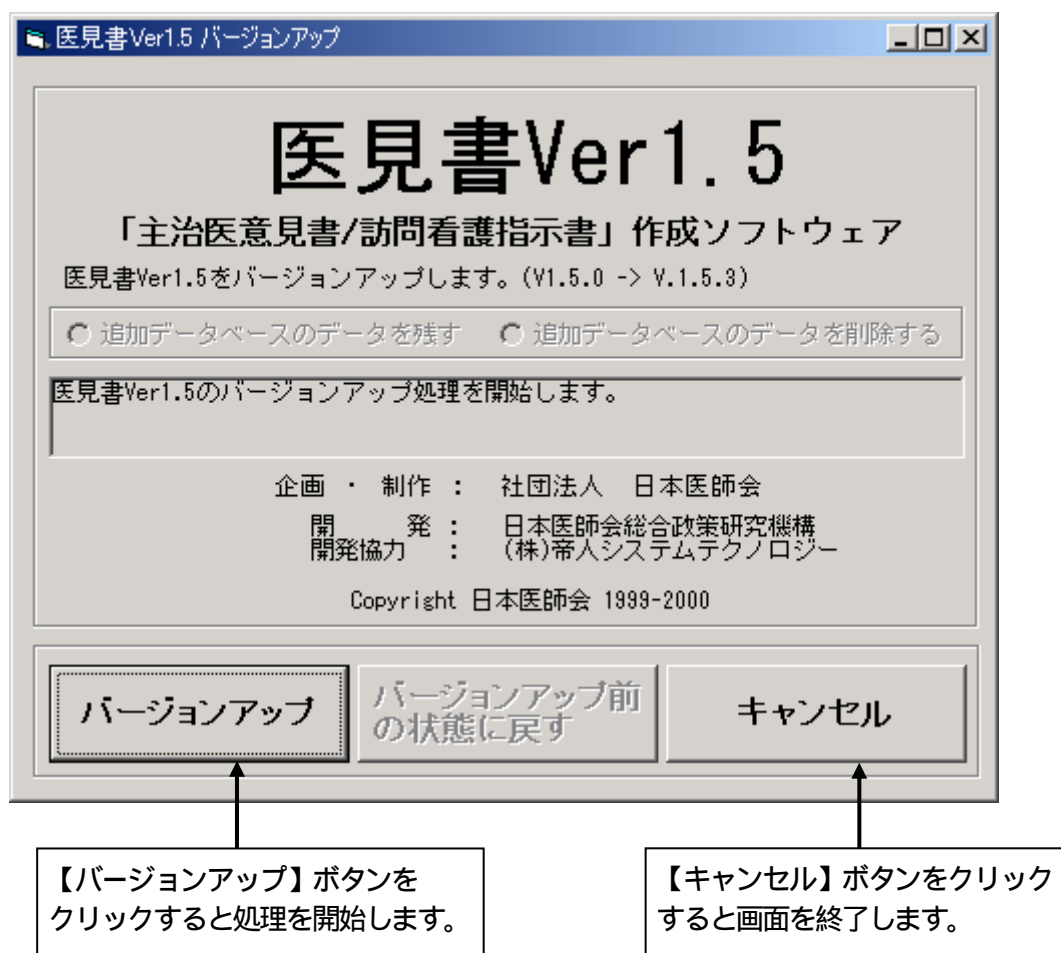
○バージョンアップ方法

①画面の下部にある【バージョンアップ】ボタンをクリックすると、下記のような処理確認メッセージボックスが表示されます。
【はい】ボタンをクリックし、バージョンアップ処理を開始します。

確認

医見書Ver1.5をバージョンアップしますか？

はい(Y)　いいえ(N)

②処理が終了すると、処理終了メッセージボックスが表示されます。
【OK】ボタンをクリックし、メッセージボックスを終了します。

終了

処理を正常終了しました。

OK
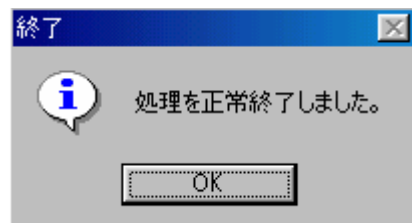
以上で医見書 Ver1.5 のバージョンアップ処理が完了しました。

3.バージョンアップ前の状態に戻す

【バージョンアップ前の状態に戻す】ボタンをクリックすると処理を開始します。

【キャンセル】ボタンをクリックすると画面を終了します。
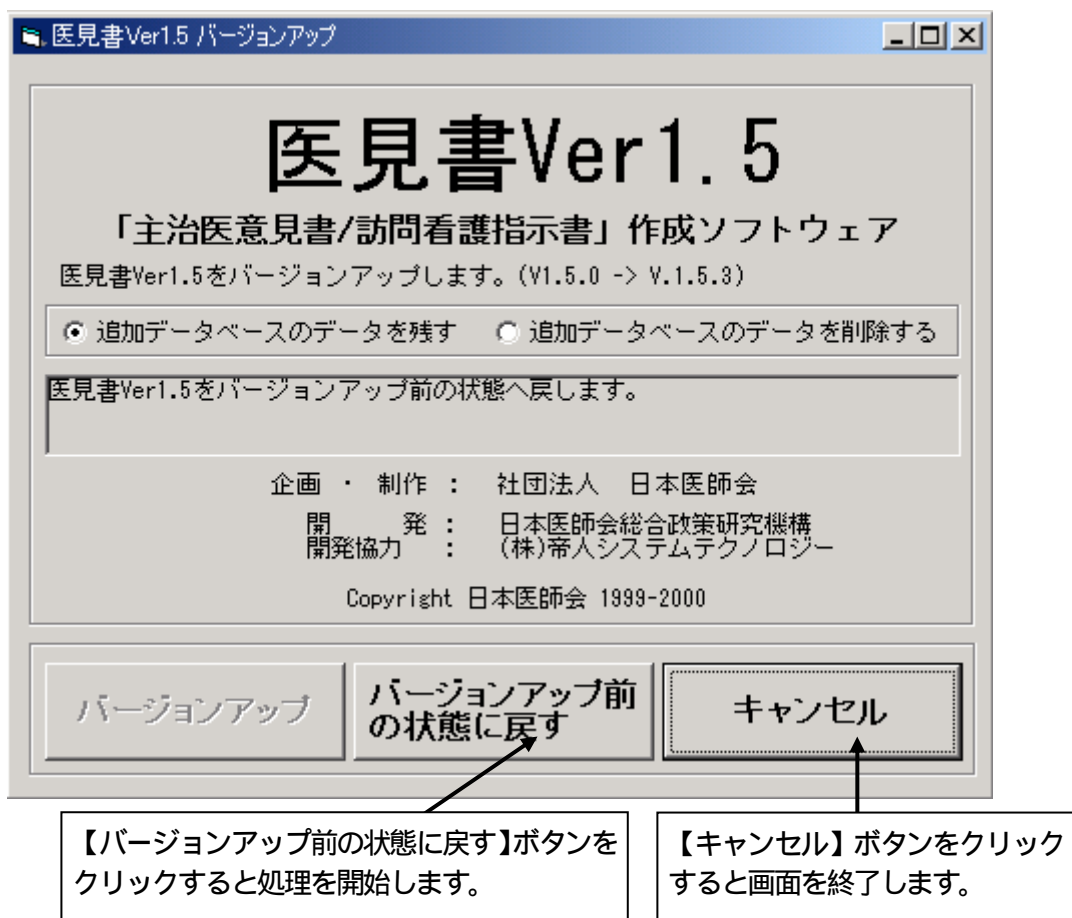
○バージョンアップ前の状態に戻す方法

前ページの手順によりバージョンアップされた医見書 Ver1.5 をバージョンアップ処理前の状態に戻す処理を行います。

①画面上部にあるオプショングループより、該当する内容のオプションボタンをクリックします。
これは、バージョンアップ処理された時に新しいデータベースが追加されるので、戻す処理を行う際に、追加されたデータベースのデータの存続を選択します。

追加データベースのデータを残す	追加データベースのデータを削除する
追加データベースのデータを残します。 次回、バージョンアップ処理を行った際にデータが反映されます。	追加データベースのデータを削除します。 次回、バージョンアップ処理を行った際に新しくデータを作成します。

②画面の下部にある【バージョンアップ】ボタンを押下すると、以下のような処理確認メッセージボックスが表示されます。
【はい】ボタンをクリックし、処理を開始します。

確認

医見書Ver1.5をバージョンアップ前の状態に戻しますか？

はい(Y)　いいえ(N)

③処理が終了すると、処理終了メッセージボックスが表示されます。
【OK】ボタンをクリックし、メッセージボックスを終了します。

終了

処理を正常終了しました。

OK
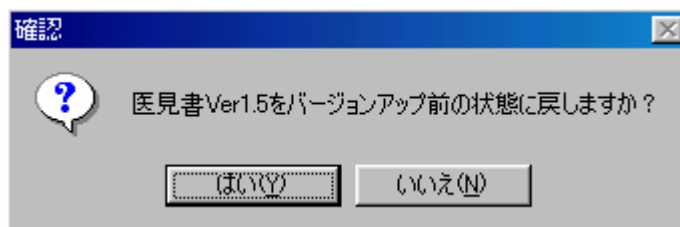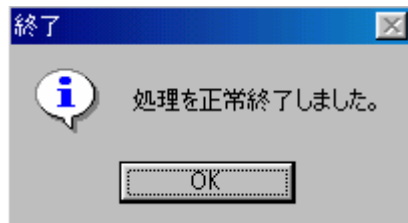
以上でバージョンアップ処理前の状態に戻す処理が完了しました。